


Certificato di Linearità

**Calme
Stab.Marcellinara**

Cod. Società Cert.:	PTA	Numero Certificato:	CG 32-25
Operatore			
Elaboratore:	Christian Giannini	Indirizzo:	S.S Adriatica Nord 51/15
Reparto:	Analisi Gas	Fax:	071.9203875
		Telefono:	071.6610013
		mail:	info@protecambiente.it
Caratteristiche analizzatore sottoposto a test			
Costruttore:	Siemens	Tipo:	Ultramat 23
Modello:	7MB2337-0AL00-3PH4	S/N:	N1-S7-566
		Comp:	NO
Inizio Scala:	0 ppm	Fondo Scala:	500 ppm
		Err [%]:	2
		Ubicazione:	H2
Note:			
Materiale di Riferimento			
Gas Riferim:	NO	Certificato:	Sapio D458829 Cert. 202306033
Valore di Riferimento:	576 ppm	Scadenza:	18-ago-25
Gas Carrier:	Aria	Certificato:	
Valore di Riferimento:		Scadenza:	-

Caratteristica di taratura

Step	% su F.S.	Valore di Riferimento	AMS Lettura 1	AMS Lettura 2	AMS Lettura 3	Residuo d _c	Residuo su F.S. d _{c,rel}	Esito
		ppm	ppm	ppm	ppm			
1	0,0%	0	0	-1	1	1,51	0,30%	OK
2	20,8%	104	101	100	99	-2,68	-0,54%	OK
3	41,0%	205	201	200	200	-3,54	-0,71%	OK
4	62,0%	310	308	305	307	-2,40	-0,48%	OK
5	97,0%	485	486	488	490	3,61	0,72%	OK
6	0,0%	0	1	3	2	3,51	0,70%	OK

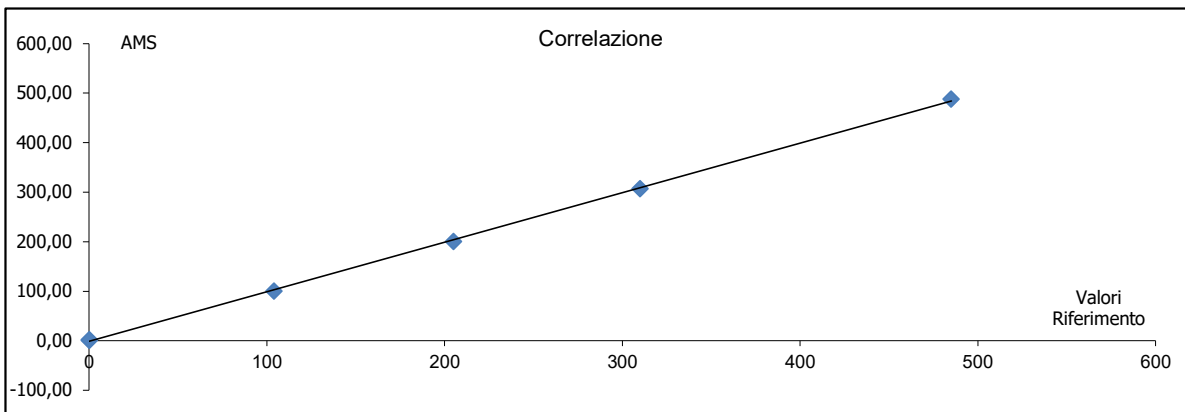

Formula di correlazione per lo strumento: **Y=0,998X+1,506**

Dati Diluitore			
Costruttore:	IAS	Tipo:	Hovacal
Cert. Num.:	2414623	S/N:	11221801
		Emesso da:	Tetratex Instruments
		Data:	11/07/2024

L'esito della prova si intende positivo se per ogni d_{c,rel} vale la seguente condizione:

d_{c,rel} < 5% secondo Norma 14181:2015

ESITO POSITIVO

Tecnico *Christian Giannini*

Data 03/04/2025