


Certificato di Linearità

**Calme
Stab.Marcellinara**

Cod. Società Cert.:	PTA	Numero Certificato:	CG 37-25
Operatore			
Elaboratore:	Christian Giannini	Indirizzo:	S.S Adriatica Nord 51/15
Reparto:	Analisi Gas	Fax:	071.9203875
		Telefono:	071.6610013
		mail:	info@protecambiente.it
Caratteristiche analizzatore sottoposto a test			
Costruttore:	Siemens	Tipo:	Oxymat 61
Modello:	7MB2001-0AF00-1DA4	S/N:	N1-U7-862
Comp:	O ₂		
Inizio Scala:	0 %	Fondo Scala:	25 %
Err [%]:	2	Ubicazione:	H3
Note:			
Materiale di Riferimento			
Gas Riferim:	Aria	Certificato:	
Scadenza:			
Valore di Riferimento:	20,96 %		
Gas Carrier:	CO-NO	Certificato:	Sapio B1149 Cert. 202409081
Scadenza:	2-dic-26		
Valore di Riferimento:			

Caratteristica di taratura

Step	% su F.S.	Valore di Riferimento	AMS Lettura 1	AMS Lettura 2	AMS Lettura 3	Residuo d _c	Residuo su F.S. d _{c,rel}	Esito
		%	%	%	%			
1	0,0%	0,00	0,00	0,05	0,03	0,06	0,22%	OK
2	17,9%	4,47	4,39	4,38	4,35	-0,08	-0,31%	OK
3	39,7%	9,93	9,87	9,85	9,84	-0,07	-0,28%	OK
4	57,6%	14,40	14,45	14,52	14,52	0,09	0,38%	OK
5	83,8%	20,95	20,95	20,95	20,95	-0,02	-0,06%	OK
6	0,0%	0,00	0,02	-0,04	-0,03	0,01	0,05%	OK

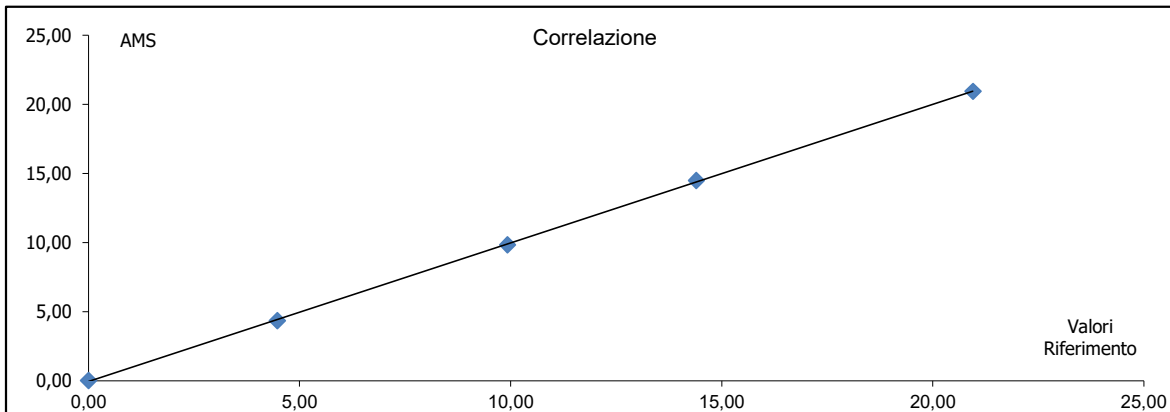

Formula di correlazione per lo strumento: **$Y=0,998X+0,029$**

Dati Diluitore			
Costruttore:	IAS	Tipo:	Hovacal
S/N:	11221801		
Cert. Num.:	2414623	Emesso da:	Tetratex Instruments
Data:	11/07/2024		

L'esito della prova si intende positivo se per ogni d_{c,rel} vale la seguente condizione:

d_{c,rel} < 5% secondo Norma 14181:2015

ESITO POSITIVO

Tecn

Christian Giannini

Data 03/04/2025