


Certificato di Linearità

Calme
Stab.Marcellinara

Cod. Società Cert.:	PTA	Numero Certificato:	CG 36-25
Operatore			
Elaboratore:	Christian Giannini	Indirizzo:	S.S Adriatica Nord 51/15
Reparto:	Analisi Gas	Fax:	071.9203875
		Telefono:	071.6610013
		mail:	info@protecambiente.it
Caratteristiche analizzatore sottoposto a test			
Costruttore:	Siemens	Tipo:	Ultramat 23
Modello:	7MB2337-0AL06-3PH4	S/N:	N1-J1-977
		Comp:	CO
Inizio Scala:	0 %	Fondo Scala:	2,5 %
		Err [%]:	2
		Ubicazione:	H3
Note:			
Materiale di Riferimento			
Gas Riferim:	CO-NO	Certificato:	Sapio B1149 Cert. 202409081
		Scadenza:	2-dic-26
Valore di Riferimento:	2,04 %		
Gas Carrier:	Aria	Certificato:	
		Scadenza:	-
Valore di Riferimento:			

Caratteristica di taratura

Step	% su F.S.	Valore di Riferimento	AMS Lettura 1	AMS Lettura 2	AMS Lettura 3	Residuo d _c	Residuo su F.S. d _{c,rel}	Esito
		%	%	%	%			
1	0,0%	0,000	0,000	0,002	0,002	0,00	0,09%	OK
2	19,6%	0,490	0,482	0,480	0,479	-0,01	-0,42%	OK
3	40,0%	1,000	1,005	1,006	1,008	0,00	0,16%	OK
4	60,4%	1,510	1,514	1,520	1,518	0,00	0,14%	OK
5	81,6%	2,040	2,041	2,044	2,046	0,00	-0,08%	OK
6	0,0%	0,000	0,001	0,002	0,003	0,00	0,11%	OK

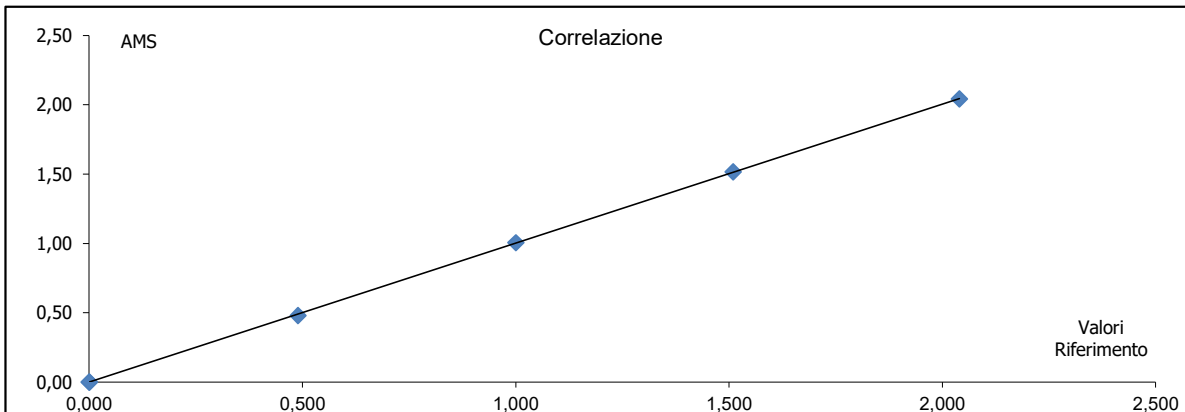

Formula di correlazione per lo strumento: **$Y=0,997X+0,001$**

Dati Diluitore			
Costruttore:	IAS	Tipo:	Hovacal
		S/N:	11221801
Cert. Num.:	2414623	Emesso da:	Tetratex Instruments
		Data:	11/07/2024

L'esito della prova si intende positivo se per ogni d_{c,rel} vale la seguente condizione:

d_{c,rel} < 5% secondo Norma 14181:2015

ESITO POSITIVO

Tecnico *Christian Giannini*

Data 03/04/2025