


Certificato di Linearità

**Calme
Stab.Marcellinara**

Cod. Società Cert.:	PTA	Numero Certificato:	CG 35-25
Operatore			
Elaboratore:	Christian Giannini	Indirizzo:	S.S Adriatica Nord 51/15
Reparto:	Analisi Gas	Fax:	071.9203875
		Telefono:	071.6610013
		mail:	info@protecambiente.it
Caratteristiche analizzatore sottoposto a test			
Costruttore:	Siemens	Tipo:	Ultramat 23
Modello:	7MB2337-0AL06-3PH4	S/N:	N1-J1-977
		Comp:	NO
Inizio Scala:	0 ppm	Fondo Scala:	500 ppm
		Err [%]:	2
		Ubicazione:	H3
Note:			
Materiale di Riferimento			
Gas Riferim:	NO	Certificato:	Sapio D458829 Cert.202306033
		Scadenza:	18-ago-25
Valore di Riferimento:	576 ppm		
Gas Carrier:	Aria	Certificato:	
		Scadenza:	-
Valore di Riferimento:			

Caratteristica di taratura

Step	% su F.S.	Valore di Riferimento	AMS Lettura 1	AMS Lettura 2	AMS Lettura 3	Residuo d _c	Residuo su F.S. d _{c,rel}	Esito
		ppm	ppm	ppm	ppm			
1	0,0%	0	0	-1	-2	1,58	0,32%	OK
2	20,2%	101	99	98	97	-1,00	-0,20%	OK
3	40,6%	203	199	200	198	-2,84	-0,57%	OK
4	65,0%	325	329	330	331	2,60	0,52%	OK
5	98,4%	492	493	495	495	-1,19	-0,24%	OK
6	0,0%	0	-1	-2	-1	1,33	0,27%	OK

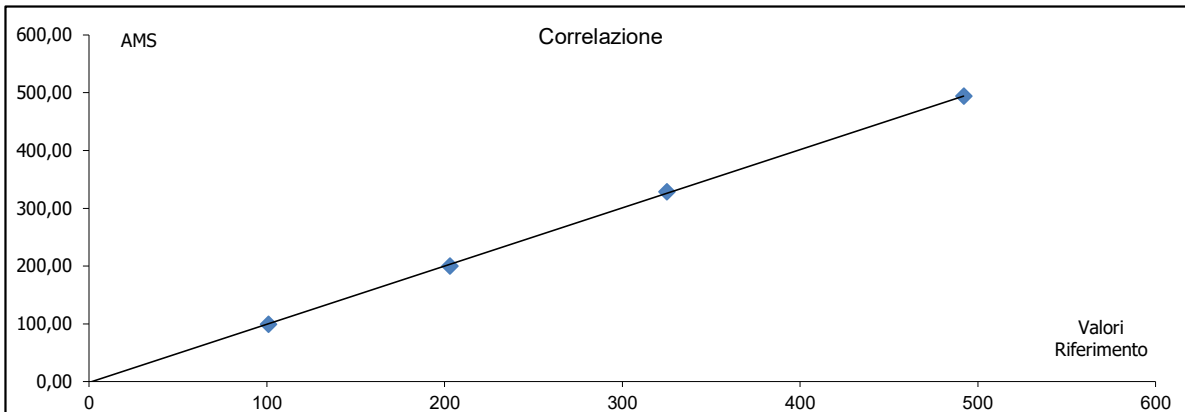

Formula di correlazione per lo strumento: **$Y=0,989X+2,31$**

Dati Diluitore

Costruttore:	IAS	Tipo:	Hovacal	S/N:	11221801
Cert. Num.:	2414623	Emesso da:	Tetratex Instruments	Data:	11/07/2024

L'esito della prova si intende positivo se per ogni d_{c,rel} vale la seguente condizione:

d_{c,rel} < 5% secondo Norma 14181:2015

ESITO POSITIVO

Tecnico

Christian Giannini

Data 03/04/2025