


Certificato di Linearità

**Calme
Stab.Marcellinara**

Cod. Società Cert.:	PTA	Numero Certificato:	CG 38-25
Operatore			
Elaboratore:	Christian Giannini	Indirizzo:	S.S Adriatica Nord 51/15
Reparto:	Analisi Gas	Fax:	071.9203875
		Telefono:	071.6610013
		mail:	info@protecambiente.it
Caratteristiche analizzatore sottoposto a test			
Costruttore:	Siemens	Tipo:	Ultramat 23
Modello:	7MB2337-0AL00-3PH4	S/N:	N1-S7-569
Inizio Scala:	0 ppm	Comp:	CO
Fondo Scala:	5000 ppm	Err [%]:	2
		Ubicazione:	H4
Note:			
Materiale di Riferimento			
Gas Riferim:	CO	Certificato:	Sapio D477140 Cert. 202409082
Valore di Riferimento:	3981 ppm	Scadenza:	2-dic-27
Gas Carrier:	Aria	Certificato:	
Valore di Riferimento:		Scadenza:	-

Caratteristica di taratura

Step	% su F.S.	Valore di Riferimento	AMS Lettura 1	AMS Lettura 2	AMS Lettura 3	Residuo d _c	Residuo su F.S. d _{c,rel}	Esito
		ppm	ppm	ppm	ppm			
1	0,0%	0	0	3	5	7,01	0,14%	OK
2	19,8%	991	972	975	979	-10,33	-0,21%	OK
3	39,8%	1988	1966	1970	1971	-12,67	-0,25%	OK
4	59,7%	2987	2980	2977	2979	-1,01	-0,02%	OK
5	79,6%	3981	3981	3983	3983	9,65	0,19%	OK
6	0,0%	0	2	3	4	7,34	0,15%	OK

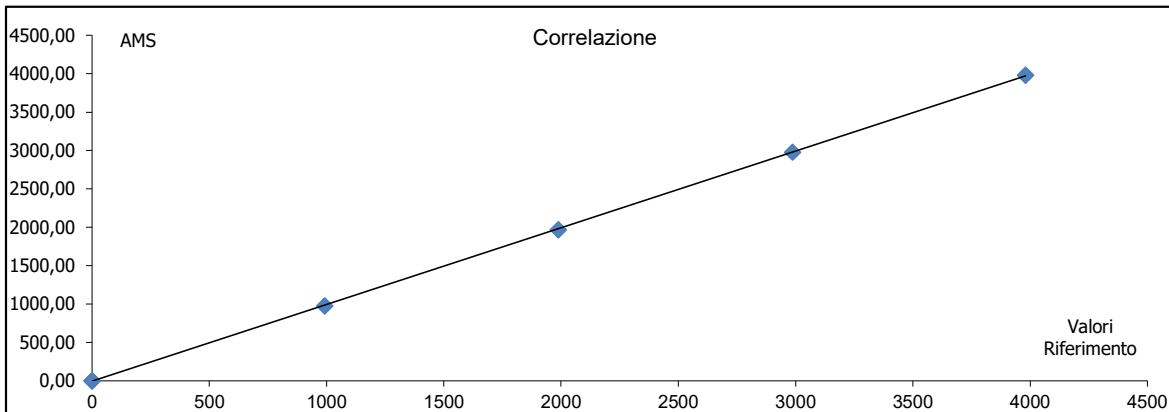

Formula di correlazione per lo strumento: **$Y=1,001X+4,348$**

Dati Diluitore			
Costruttore:	IAS	Tipo:	Hovacal
Cert. Num.:	2414623	S/N:	11221801
		Emesso da:	Tetratex Instruments
		Data:	11/07/2024

L'esito della prova si intende positivo se per ogni d_{c,rel} vale la seguente condizione:

d_{c,rel} < 5% secondo Norma 14181:2015

ESITO POSITIVO

Tecni

Christian Giannini

Data 03/04/2025